



Ostrow Mazowiecka, dnia 06.03.2023 r.

nr postępowania: SPZZOZ.XII.381.3/2023/ZP/PU

Do wszystkich, którzy ubiegają się
o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZO

Dotyczy: Zapytania Ofertowego prowadzonego na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) na: „*zakup wyrobów medycznych do zabiegów hemodynamicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej*”.

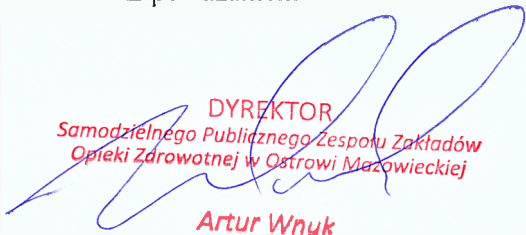
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, w odpowiedzi na zapytania do ZO wyjaśnia:

Pakiet Nr 1

Zapytanie: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty w zakresie poz. 1 w pakiecie Nr 1 - zestawu do kontrapulsacji wewnątrzortalnej, o następujących parametrach: średnica 7,5F / 40 ml i 50 ml, cewnik zakończony miękkim końcem (soft tip) bardzo dobrze widzialnym w Rtg, budowa cewnika umożliwiająca wprowadzenie bez udziału przewodnika, balon pokryty powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie cewnika, gładkie przejście pomiędzy balonem a shaftem minimalizujące ryzyko krwawienia., znaczniki umożliwiające precyzyjne repozycjonowanie bez udziału skopii, kanał wewnętrzny wykonany z materiału atrombogennego minimalizującego możliwość zablokowania pomiaru ciśnienia, w zestawie: introduktor z niskooporową zastawką hemostatyczną, dwa przewodniki "J" 0.025" x 150 cm powlekany PTFE oraz 0.035", igła angiograficzna 18G x 7 cm, 2 dilatatory, skalpel, przedłużacz z kranikiem trójdrożnym, konektor jednokierunkowy, strzykawka typu Luer – Lock. Obecny opis przedmiotu zamówienia, konstrukcja w/w pakietu uniemożliwia nam złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu w bardzo konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Artur Wnuk